

\* 2016年 2月(第4版)

\*\* 2017年 8月(第5版)

届出番号26B2X10018000016

一般医療機器 器70 歯科技工用高周波鋳造器 JMDN 70751000

## キャスコム S

### 【警告】


- ①高温のリング等を扱うため、断熱手袋を装備して、やけどをしないように注意すること。
- ②溶融金属を直視すると、視力障害を起こします。溶融確認には遮光板を使用し、防護めがねを着用すること。

### 【禁忌・禁止】

ルツボ、リングなどの消耗品は弊社のものを使用すること。他社のものを使用すると、故障したり、ケガをする可能性があります。

### 【形状・構造及び原理等】

装置外観図

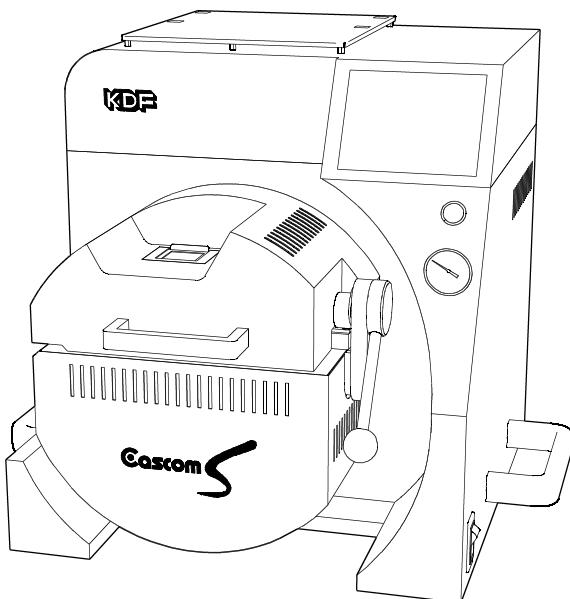

### 【使用目的又は効果】

高周波により歯科用合金を溶融・鋳造する装置。

### \* 【使用方法等】

#### 1) 取り付け、設置

付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりとした机に設置すること。

#### 2) 操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
  - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
  - ②接続されている圧縮空気の圧力は 0.5MPa 以上、1MPa 以下であること。
  - ③アルゴンガスを使用する場合、その圧力は 0.7MPa 以上、0.8MPa 以下であること。
  - ④周囲に燃えやすい物が無いこと。
- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
  - ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
  - ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
  - ③外装温度が上昇するため、体が機器に触れないようにすること。
- 4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
  - ①電源スイッチを切り、機器の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。
  - ②アルゴンボンベのバルブを閉めること。

### 【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「日常のお手入れ」の項をお読みください。

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* TEL 075-574-1000

#### 2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社